

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ: **ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΜΟΝ. Α.Ε.**
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 16/3/2026

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ: 21140



ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΜΟΝ. Α.Ε.

12ο Χλμ Παλαιάς Οδού Θεσ/νίκης – Κιλκίς
Τηλ 2310787129, 787157 Fax 2310787821

Σελ 1 από 3

ΠΕΛΑΤΗΣ:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:	ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Α.Ε.
ΤΥΠΟΣ:	ΕΒ - 18Χ3
SERIAL NUMBER:	278001/12
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:	12/3/26

Παρατηρήσεις:

Ψηφιακός Ενδείκτης: MD5-2Amax

Δυναμικότητα: 60TN

Διακριτική ικανότητα: 20kg

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ	
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:	11°C
ΥΓΡΑΣΙΑ:	65,00%

Πρότυπα Μάζας που χρησιμοποιήθηκαν:

Τα πρότυπα μάζας, που χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο, εξασφαλίζουν συσχετισμό ακρίβειας μετρήσεων στο BIPM (Διεθνές Πρότυπο 1Kg).

Αριθμός πιστοποιητικού Προτύπων Αναφοράς: **W 2025/345-B, W 2025/346-B, W 2025/347-B, W 2024/348-B, W 2025/349-B, W 2025/350-B, W 2025/351-B, W 2025/352-B, W 2025/353-B, W 2025/356-B, W 2025/357-B, W 2025/358-B.**

Αβεβαιότητα Μετρήσεων:

Η αβεβαιότητα της αξίας μάζας των προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν είναι της τάξης ακρίβειας OIML M2.

Διαδικασία ελέγχου:

1. Έλεγχος οριζοντίωσης του ζυγού
2. Ρύθμιση του ζυγού με πρότυπα βάρη
3. Έλεγχος έκκεντρης τοποθέτησης βάρους
4. Δοκιμή υστέρησης με αύξουσα – φθίνουσα αξία μάζας
5. Έλεγχος επαναληψιμότητας
6. Έλεγχος γραμμικότητας του ζυγού σε διάφορα σημεία της κλίμακας

Υπογραφή υπευθύνου διακρίβωσης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΜΟΝ. Α.Ε.

12ο Χλμ Παλαιάς Οδού Θεσ/νίκης – Κιλκίς
Τηλ 2310787129, 787157 Fax 2310787821

Αριθ. Πιστοποιητικού: 21140

Σελ 2 από 3


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΔΟΚΙΜΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

ΒΑΡΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΥΞΟΥΣΑ	ΒΑΡΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΘΙΝΟΥΣΑ
0kg	0kg	0kg	34620kg
2000kg	2000kg	22620kg	12000kg
1000kg	3000kg	2000kg	10000kg
1000kg	4000kg	2000kg	8000kg
1000kg	5000kg	1000kg	7000kg
1000kg	6000kg	1000kg	6000kg
1000kg	7000kg	1000kg	5000kg
1000kg	8000kg	1000kg	4000kg
2000kg	10000kg	1000kg	3000kg
2000kg	12000kg	1000kg	2000kg
22620kg	34620kg	2000kg	0kg

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΚΕΝΤΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ	ΕΝΔΕΙΞΗ
1	34620kg
2	34600kg
3	34600kg
4	34620kg
5	34620kg
6	34620kg

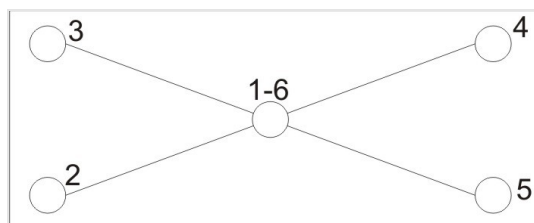

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑΣ

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ	α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ
1	34620kg	4	34620kg
2	34600kg	5	34620kg
3	34620kg	6	34620kg

Υπογραφή υπευθύνου διακρίβωσης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΜΟΝ. Α.Ε.

12ο Χλμ Παλαιάς Οδού Θεσ/νίκης – Κιλκίς
Τηλ 2310787129, 787157 Fax 2310787821

Αριθ. Πιστοποιητικού: 21140

Σελ 3 από 3

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΒΑΡΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΕΝΔΕΙΞΗ
1000kg	1000kg
6000kg	6000kg
12000kg	12000kg
34620kg	34620kg

- Η απόλυτη απόκλιση της ένδειξης του ζυγού είναι στρογγυλεμένη στα επίπεδα της διακριτικότητας του.
- Οι αναγραφόμενες τιμές απόκλισης ισχύουν για την κατάσταση που βρισκόταν ο ζυγός κατά τον χρόνο ελέγχου.
- Συνιστάται επανέλεγχος μετά από ένα έτος.

Υπογραφή υπευθύνου ελέγχου